

# DEVILBISS®



*515A Series  
Serie de 515A  
Série 515A*

## ***DeVilbiss®* Oxygen Concentrator Instruction Guide**

WARNING- Read instruction guide before operating this equipment.


CAUTION- Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

 DANGER-NO SMOKING

## **Guía de Instrucciones del Concentrador de Oxígeno de *DeVilbiss®***

ADVERTENCIA- Lea la guía de instrucciones antes de poner a funcionar este equipo.

PRECAUCION- La ley federal (EE.UU.) establece que este aparato sólo lo puede vender un médico o por prescripción del mismo.

 PELIGRO-NO FUMAR

## **Guide d'instructions Concentrateur d'Oxygène *DeVilbiss®***

AVERTISSEMENT- Lire le mode d'emploi avant d'utiliser ce dispositif.

ATTENTION- En vertu de la Loi fédérale américaine, la vente de cet appareil n'est autorisée que par un médecin ou sur ordonnance de ce dernier.

 DANGER-NE PAS FUMER

 **SUNRISE  
MEDICAL®**

**TABLE OF CONTENTS**

Important Safeguards .....	3
Introduction .....	3
Why Your Physician Prescribed Supplemental Oxygen .....	3
How Your Concentrator Works .....	3
Important Parts of Your Concentrator .....	4
Setting Up Your Concentrator .....	5
Before Operating Your Concentrator .....	5
Operating Your Concentrator .....	5
Reserve Oxygen System .....	6
Caring for Your Concentrator .....	7
Troubleshooting .....	8
Specifications .....	9
Declaration of Conformity .....	9
<b>ESPAÑOL</b> .....	10
<b>FRANÇAIS</b> .....	18

**CAUTION**– Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

**INDICATIONS FOR USE**– The DeVilbiss Oxygen Concentrator is intended for use as an oxygen concentrator to provide supplemental low flow oxygen therapy in the home, nursing homes, patient care facilities, etc.

### **▲ WARNING**

**Under certain circumstances, oxygen therapy can be hazardous.  
Seeking medical advice before using an oxygen concentrator is advisable.**

#### **Physician Information**

Physician Name: \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

#### **Prescription Information**

Name: \_\_\_\_\_

Oxygen liters per minute

at rest: \_\_\_\_\_ during activity: \_\_\_\_\_

other: \_\_\_\_\_

#### **Oxygen use per day**

Hours: \_\_\_\_\_ Minutes: \_\_\_\_\_

Comments: \_\_\_\_\_

**DeVilbiss Oxygen Concentrator Serial Number:** \_\_\_\_\_

**(check one)**


5-Liter                       5-Liter with OSD                       \_\_\_\_\_

#### **Sunrise Medical/DeVilbiss Equipment Provider Information**

Set-Up Person: \_\_\_\_\_

This instruction guide was reviewed with me and I have been instructed on the safe use and care of the DeVilbiss Oxygen Concentrator.

Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_



**DeVilbiss 5-Liter Series**

## IMPORTANT SAFEGUARDS

**▲** Read this entire guide before using your DeVilbiss concentrator. Important information is highlighted by these terms throughout this guide:

**DANGER** Urgent safety information for hazards that will cause serious injury or death.

**WARNING** Important safety information for hazards that might cause serious injury.

**CAUTION** Information for preventing damage to the product.

**NOTE** Information to which you should pay special attention.

Important safeguards are indicated throughout this guide; pay special attention to all safety information.

 DANGER—NO SMOKING

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### INTRODUCTION

This instruction guide will acquaint you with the DeVilbiss oxygen concentrator. Make sure that you read and understand this guide before operating your unit. Important safeguards are indicated throughout this guide; pay special attention to all safety information. Contact your Sunrise Medical/DeVilbiss equipment provider should you have any questions.

#### **▲ WARNING**

**For your safety, the oxygen concentrator must be used according to the prescription determined by your physician.**

#### **▲ DANGER**

**Oxygen causes rapid burning. Do not smoke while your oxygen concentrator is operating, or when you are near a person utilizing oxygen therapy. Do not use within 5 feet (1.6m) of hot, sparking objects or naked sources of flame.**

### Why Your Physician Prescribed Supplemental Oxygen

Today, many people suffer from heart, lung, and other respiratory diseases. Many of these people can benefit from supplemental oxygen therapy. Your body requires a steady supply of oxygen to function properly. Your physician prescribed supplemental oxygen for you because you are not getting enough oxygen from room air alone. Supplemental oxygen will increase the amount of oxygen that your body receives.

Supplemental oxygen is not addictive. Your physician prescribed a specific oxygen flow to improve symptoms such as headaches, drowsiness, confusion, fatigue, or increased irritability. If these symptoms persist after you begin your supplemental oxygen program, consult your physician.

### How Your DeVilbiss Oxygen Concentrator Works

Oxygen concentrators are the most reliable, efficient, and convenient source of supplemental oxygen available today. The oxygen concentrator is electrically operated. The unit separates oxygen from room air which allows high-purity supplemental oxygen to be delivered to you through the oxygen outlet. Although the concentrator filters the oxygen in a room, it will not affect the normal amount of oxygen in your room.

## IMPORTANT PARTS OF YOUR CONCENTRATOR

Please take time to familiarize yourself with your DeVilbiss oxygen concentrator before operating.

### Front View (Figure 1)

1. Operating instructions
2. Green Power light – illuminates when your concentrator is operating.
3. Power Switch  
| = ON  
O = OFF
4. Flow meter knob
5. Flow meter
6. Circuit breaker – (selected units) resets the unit after electrical overload shutdown.
7. Oxygen outlet – oxygen is dispersed through this port.
8. Normal Oxygen (green) light – ONLY on units with the OSD® (see page 6).
9. Low Oxygen (yellow) light – ONLY on units with the OSD® (see page 6).
10. Red Service Required light – when illuminated contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider.

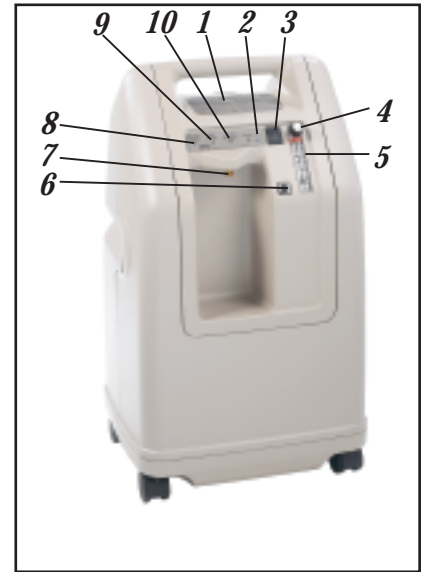


Figure 1

### Back View (Figure 2)

11. Important Safeguards
12. Handgrip
13. Exhaust
14. Power cord and/or IEC power connector.
15. Line cord strap
16. Air filter – prevents dirt, dust, and lint from entering your unit.



Figure 2

### Accessories

The accessories below are approved for use with DeVilbiss Oxygen Concentrators:

Bubble Humidifier (200 ml Capacity)	
- 50/case .....	HUM16
Cannula (disposable)	
- 50/case .....	CAN00
Cannula w/ 2.1 m (7 ft) Oxygen Tubing (disposable)	
- 50/case .....	CAN70
Oxygen Outlet Connector	
- Plastic - 1/pack.....	CN100
Oxygen Tubing (disposable)	
- 2.1 m (7 ft) - 50/case .....	OST07
- 4.2 m (14 ft) - 50/case .....	OST15
- 7.5 m (25 ft) - 25/case .....	OST25
- 15 m (50 ft) - 15/case .....	OST50

**NOTE**– The use of certain humidifiers and accessories not specified above may impair the oxygen concentrator's performance.

## SETTING UP YOUR OXYGEN CONCENTRATOR

1. Position your unit near an electrical outlet in the room where you spend most of your time.

### **⚠ DANGER**

**Keep the oxygen concentrator at least 5 feet (1.6 m) from hot, sparking objects or naked sources of flame.**

**NOTE**– Do not connect to an electrical outlet controlled by a wall switch. No other appliances should be plugged into the wall outlet.

2. Position your unit at least 6 inches (16 cm) from walls, draperies, or any other objects that might prevent the proper flow of air in and out of your oxygen concentrator. The oxygen concentrator should be located so as to avoid pollutants or fumes.

## BEFORE OPERATING YOUR OXYGEN CONCENTRATOR

1. Before operating your unit, always check to be sure the air filter (located on the back of your unit) is clean. Proper cleaning of this filter is discussed in the Caring For Your Concentrator section on page 7.

2. Attach the appropriate oxygen accessories to the oxygen outlet.

### **Oxygen Tubing Connection:**

- a. Thread the oxygen outlet connector onto the oxygen outlet.
- b. Attach the oxygen tubing directly to the connector (**Figure 3**).

### **Oxygen Tubing Connection With Humidification:**

If your physician has prescribed an oxygen humidifier as part of your therapy, follow these steps:

- a. Fill the humidifier bottle with distilled water. Do not overfill. (If using a prefill, go to letter b.)
  - b. Thread the wing nut located on the top of the humidifier bottle to the oxygen outlet so that it is suspended (**Figure 4**). Make sure it is securely tightened.
  - c. Attach the oxygen tubing directly to the humidifier bottle outlet fitting (**Figure 5**).
3. Your physician has prescribed either a nasal cannula, catheter, or face mask. In most cases, they are already attached to the oxygen tubing. If not, follow the manufacturer's instructions for attachment.
  4. Remove the power cord completely from the line cord strap. Make sure the power switch is in the "Off" position, and insert the plug into the wall outlet. The unit is double insulated to guard against electric shock.

**NOTE**–(only 115 volt units) The plug on the DeVilbiss oxygen concentrator has one blade wider than the other. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a wall outlet only one way. Do not attempt to defeat this safety feature.

### **⚠ WARNING**

**Improper use of the power cord and plugs can cause a burn, fire, or other electric shock hazards. Do not use the unit if the power cord is damaged.**

## OPERATING YOUR DEVILBISS OXYGEN CONCENTRATOR

### **⚠ DANGER**

**Oxygen causes rapid burning. Do not smoke while your oxygen concentrator is operating, or when you are near a person utilizing oxygen therapy. Keep the oxygen concentrator at least 5 feet (1.6 m) from hot, sparking objects or naked sources of flame.**

### **⚠ DANGER**

**Do not lay the cannula down while the concentrator is delivering oxygen. High concentrations of oxygen can cause rapid burning.**

1. Press the power switch to the "On" position. When the unit is turned on, the Power light will illuminate, and the patient alert system – Service Required light and audible signal – will briefly alarm.



*Figure 3*



*Figure 4*



*Figure 5*

**DEVILBISS OXYGEN CONCENTRATORS WITH OSD ONLY**

The OSD (Oxygen Sensing Device) is a device within your concentrator that monitors the oxygen produced by your unit. When the unit is turned "On," all four lights (Power, Service Required, Low Oxygen, and Normal Oxygen) on the front panel will illuminate briefly. After a few seconds, only the Power and Normal Oxygen lights will remain lit.

The OSD lights on the front panel are defined as follows:

- Green Normal Oxygen light—acceptable oxygen level.
- Yellow Low Oxygen light— below an acceptable oxygen level.

If the oxygen purity falls below the acceptable level, the green Normal Oxygen light will shut off and the yellow Low Oxygen light will illuminate. Switch to your reserve oxygen system. Refer to the Minor OSD Troubleshooting section in this guide on page 8 and contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider.

As an added safety feature should the oxygen purity continue to drop, an intermittent audible signal will sound. Contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider immediately. Do not attempt any other maintenance.

**NOTE**— If the Service Required light illuminates and the audible signal alarms but the unit is not operating, there is no power to the unit. Refer to the Minor Troubleshooting chart on page 8 and contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider if necessary.

**NOTE**— If an audible low-frequency vibration sound is detected, the unit is not operating properly. Refer to the Minor Troubleshooting chart on page 8, and contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider if necessary.

2. Check the flow meter to make sure that the flow meter ball is centered on the line next to the prescribed number of your flow rate.

**CAUTION**— It is very important to follow your oxygen prescription. Do not increase or decrease the flow of oxygen— consult your physician.

**NOTE**— Your Sunrise Medical/DeVilbiss provider may have preset the flow meter so that it can not be adjusted.

**NOTE**— If the flow meter knob is turned clockwise, the flow decreases (and eventually will shut off the oxygen flow). If the knob is turned counterclockwise, the flow increases.

**NOTE**— The low-flow alarm will activate if the flow meter ball is set below .3 lpm. The unit will continue to run; however, the Service Required light will come on accompanied by an audible alarm. Adjust the flow meter to your prescribed flow.

3. Your DeVilbiss concentrator is now ready for use, properly position the cannula or mask (**Figure 6**). Allow 20 minutes for oxygen concentrator to reach stated performance.

**RESERVE OXYGEN SYSTEM**

As a precaution, your Sunrise Medical/DeVilbiss provider may supply you with a reserve oxygen system. If your unit loses electrical power or fails to operate correctly, the Patient Alert System will sound to signal you to switch to your reserve oxygen system (if provided) and contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider.



**Figure 6**

## CARING FOR YOUR DEVILBISS OXYGEN CONCENTRATOR

**Note**– Use no lubricants, oils or grease.

### **⚠ WARNING**

Before attempting any cleaning procedures, turn the unit “Off.”

#### Oxygen Humidifier (reusable bottles)

If your physician has prescribed humidification, clean your humidifier bottle daily. Follow the instructions supplied by the manufacturer. If no cleaning instructions were supplied, follow these steps:

1. Wash the humidifier in a solution of hot water and dishwashing detergent (**Figure 7**).
2. Soak the humidifier in a solution of one part white vinegar to three parts hot water for 30 minutes (**Figure 8**). This solution acts as a germicidal agent.
3. Rinse thoroughly with hot tap water and refill with distilled water (**Figure 9**) for use. Do not overfill.

#### Cannula, Mask, and Tubing

Clean and replace the cannula, mask, and tubing as instructed by your Sunrise Medical/DeVilbiss provider.

#### Air Filter and Oxygen Outlet Connector

The air filter and connector should be cleaned at least once a week. To clean, follow these steps:

1. Remove the air filter, located on the back of the unit. Remove the oxygen outlet connector (if used).
2. Wash in a solution of warm water and dishwashing detergent (**Figure 10**).
3. Rinse thoroughly with warm tap water and towel dry. The filter should be completely dry before reinstalling.

**CAUTION**– To prevent product damage, do not attempt to operate the unit without the air filter or while the filter is still damp.

#### Exterior Cabinet

### **⚠ WARNING**

To avoid electric shock, do not remove the concentrator cabinet. The cabinet should only be removed by a qualified Sunrise Medical/DeVilbiss technician. Do not apply liquid directly to the cabinet or utilize any petroleum-based solvents or cleaning agents.

Clean the concentrator exterior cabinet by using a damp cloth or sponge with a mild household cleaner and wipe it dry.



*Figure 7*



*Figure 8*



*Figure 9*



*Figure 10*



**TROUBLESHOOTING**

The following troubleshooting chart will help you analyze and correct minor oxygen concentrator malfunctions. If the suggested procedures do not help, switch to your reserve oxygen system and call your Sunrise Medical/DeVilbiss homecare provider. Do not attempt any other maintenance.

**⚠ WARNING**

**To avoid electric shock hazard, do not remove the cabinet. The cabinet should only be removed by a qualified Sunrise Medical/DeVilbiss homecare technician.**

**MINOR TROUBLESHOOTING CHART**

Symptom	Possible Cause	Remedy
A. Unit does not operate. Power light is off when the power switch is "On." Audible alarm is pulsing and Service Required light is flashing.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Power cord not properly inserted into wall outlet.</li> <li>2. No power at wall outlet.</li> <li>3. Oxygen concentrator circuit breaker activated (selected units).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check power cord connection at the wall outlet. On 230 volt units, also check the back of the unit.</li> <li>2. Check your home circuit breaker and reset if necessary. Use a different wall outlet if the situation occurs again.</li> <li>3. Press the concentrator circuit breaker reset button (if equipped) located below the power switch. Use a different wall outlet if the situation occurs again. If the above remedies do not work, contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider.</li> </ol>
B. Unit operates, the Power light is on when the power switch is "On." Red Service Required light is illuminated. Audible alarm may be sounding.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air filter is blocked.</li> <li>2. Exhaust is blocked.</li> <li>3. Blocked or defective cannula, catheter, face mask, or oxygen tubing.</li> <li>4. Blocked or defective humidifier bottle.</li> <li>5. Flow meter set too low.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the air filter. If the filter is dirty, wash it following the cleaning instructions on page 7.</li> <li>2. Check the exhaust area; make sure there is nothing restricting the unit exhaust.</li> <li>3. Detach cannula, catheter, or face mask. If proper flow is restored, clean or replace if necessary. Disconnect the oxygen tubing at the oxygen outlet. If proper flow is restored, check oxygen tubing for obstructions or kinks. Replace if necessary.</li> <li>4. Detach the humidifier from the oxygen outlet. If proper flow is obtained, clean or replace humidifier.</li> <li>5. Set flow meter to prescribed flow rate. If the above remedies do not work, contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider.</li> </ol>
C. Unit operates, the power light is on when power switch is "on," audible low-frequency vibration sound is detected.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn your unit "Off." Switch to your reserve oxygen system, and contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider immediately.</li> </ol>
D. If any other problems occur with your oxygen concentrator.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn your unit "Off." Switch to your reserve oxygen system, and contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider immediately.</li> </ol>

**MINOR TROUBLESHOOTING CHART - ONLY OSD CONCENTRATORS**

Visual Indicator Lights	Possible Cause	Remedy
A. Both the green Normal Oxygen and the yellow Low Oxygen lights are either on or off.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OSD malfunction.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider.</li> </ol>
B. Yellow Low Oxygen light is on or the yellow Low Oxygen light is on and the intermittent audible signal is sounding.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flow meter is not properly set.</li> <li>2. Air filter is blocked.</li> <li>3. Exhaust is blocked.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure the flow meter is properly set to the prescribed number.</li> <li>2. Check the air filter. If the filter is dirty, wash it following the cleaning instructions on page 7.</li> <li>3. Check the exhaust area; make sure there is nothing restricting the unit exhaust.</li> </ol>
C. Red Service Required light is on and an intermittent audible signal is sounding.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flow meter is not properly set.</li> <li>2. Air filter is blocked.</li> <li>3. Exhaust is blocked.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure the flow meter is properly set to the prescribed number.</li> <li>2. Check the air filter. If the filter is dirty, wash it following the cleaning instructions on page 7.</li> <li>3. Check the exhaust area; make sure there is nothing restricting the unit exhaust. If the above remedies do not work, contact your Sunrise Medical/DeVilbiss provider.</li> </ol>



SPECIFICATIONS

<b>DEVILBISS 5-LITER SERIES</b>	
<b>Catalog Number</b>	<b>515ADS, 515ADZ</b>
<b>Delivery Rate</b> (Lower delivery rates available for low flow applications)	1 to 5 LPM
<b>Maximum Recommended Flow</b>	5 LPM
<b>Outlet Pressure</b>	8.5 psig (58.6 kPa)
<b>Electrical Rating</b>	115 V, 60 Hz, 4.1 Amp
<b>Operating Voltage Range</b>	97-127 V~, 60 Hz
<b>Oxygen Percentage</b>	1-5 LPM=93%±3%
<b>Operating Altitude</b> (tested at 21°C only) 0-1500 M (0-4921 ft)  1500-3000 M (4921-9842 ft) 3000-4000 M (9842-13123 ft)	<p><i>Across the voltage range:</i> No degradation of performance</p> <p><i>Tested at nominal voltage only:</i> No degradation in performance expected based on tests of similar products. Not recommended/Not tested</p>
<b>Operating Environment Range*</b> 10°C to 35°C, humidity range of 30% to 75%	No degradation in performance across the operating voltage range (tested at sea level).
<b>Power Consumption</b>	385 Watts Average 515ADS only-320 Watts @ 2.5 LPM & below
<b>Weight</b>	50 lbs. (22.7 Kilograms)
<b>Sound Level</b> (ISO 8359:1996 from front)	48.0 dbA overall average
<b>Dimensions</b>	27.75"H x 16"W x 14"D (70.5 x 40.6 x 35.6 cm)
<b>Pressure Relief Valve</b>	40 psig±5psig (276 kPa±34.5 kPa)
<b>Operating System</b>	Time Cycle / Pressure Swing
<b>For units equipped with an OSD the visible "low oxygen" indicator will activate at the following level</b>	84% ± 2% (The audible alarm will alert at approximately 75%. At less than 60%, the red "service required" light will activate.)
<b>Storage Conditions</b>	-40°C to 70°C, humidity range of 10% to 100%, including condensation
<b>Equipment Class and Type</b>	<input type="checkbox"/> Class II Equipment Double Insulated; ⚡ Type B Applied Part
<b>Approval Body and Safety Standard</b>	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90
<b>EMC Compliance To:</b>	IEC 60601-1-2

\*Note: The OSD performance at 10°C to 35°C, 95% R.H. through voltage range on the 515ADS verified at 670m. Specifications subject to change without notice.

**INDICE**

Normas de Seguridad Importantes.....	11
Introducción.....	11
Por Qué su Médico le Prescribió un Suplemento de Oxígeno .....	11
Cómo Funciona su Concentrador .....	11
Partes Importantes de su Concentrador.....	12
Preparación de su Concentrador.....	13
Antes de Usar su Concentrador .....	13
Uso de su Concentrador.....	13
Sistema de Oxígeno de Reserva .....	14
Cuidado de su Concentrador .....	15
Detección y Solución de Problemas .....	16
Especificaciones .....	17
Declaración de Conformidad.....	17

**PRECAUCION**– La ley federal (EE.UU.) establece que este aparato sólo lo puede vender un médico o por prescripción del mismo.

**INDICACIONES DE USO**– El Concentrador de Oxígeno DeVilbiss se usa como un concentrador de oxígeno para proporcionar terapia de oxígeno suplementaria de bajo flujo en el hogar, residencias de ancianos, establecimientos de cuidado de pacientes, etc.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Bajo ciertas circunstancias, la terapia de oxígeno puede ser peligrosa. Se aconseja pedir asesoría médica antes de usar el concentrador de oxígeno.**

**Información del médico**

Nombre del médico: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

**Información de la prescripción**

Nombre: \_\_\_\_\_

Litros de oxígeno por minuto

en reposo: \_\_\_\_\_ durante actividad: \_\_\_\_\_

otra: \_\_\_\_\_

**Uso de oxígeno por día:**

horas: \_\_\_\_\_ minutos: \_\_\_\_\_

Comentarios: \_\_\_\_\_

**Concentrador de oxígeno DeVilbiss Número de serie:** \_\_\_\_\_

(marque uno)

5-Liter

5-Liter para OSD

\_\_\_\_\_


**Información del proveedor de equipo médico en el hogar Sunrise Medical/DeVilbiss**

Persona que prepara el aparato: \_\_\_\_\_

Esta guía de instrucciones se revisó conmigo y se me ha instruido en el uso y cuidado seguro del concentrador de oxígeno DeVilbiss.

Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**Aumento**



**DeVilbiss 5-Liter Series**

## NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**▲** Lea toda la guía antes de usar su concentrador DeVilbiss. La información importante viene enfatizada con este tipo de palabras de aviso en toda la guía:

**PELIGRO** Información de seguridad urgente que involucra riesgos que puedan causar serias lesiones o la muerte.

**ADVERTENCIA** Información de seguridad importante que advierte la posibilidad de una lesión seria.

**PRECAUCION** Información que previene el daño del aparato.

**NOTA** Información a la que debe prestar atención especial.

Se indican las normas de seguridad importantes a través de esta guía; preste atención especial a toda la información de seguridad.



**PELIGRO—NO FUMAR**

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

### INTRODUCCIÓN

Esta guía de instrucciones le informará acerca del concentrador de oxígeno de DeVilbiss. Asegúrese de leer y entender esta guía antes de usar su unidad. Se indican las normas de seguridad importantes a través de esta guía; preste atención especial a toda la información de seguridad. Contacte a su proveedor de equipo médico del hogar Sunrise Medical/DeVilbiss en caso de tener cualquier duda.

### **▲ ADVERTENCIA**

**Por su seguridad el concentrador de oxígeno debe usarse de acuerdo con la prescripción determinada por su médico.**

### **▲ PELIGRO**

**El oxígeno se puede quemar rápidamente. No fume cuando el concentrador de oxígeno está funcionando o cuando está cerca de una persona que está bajo terapia de oxígeno. No lo use dentro de una distancia de 1,6m (5 pies) de objetos calientes o que producen chispas ni de fuentes de llama descubiertas.**

### **Por qué su médico le prescribió un suplemento de oxígeno**

Hoy en día mucha gente tiene padecimientos del corazón, pulmones y de otras enfermedades respiratorias. Una gran cantidad de esa gente puede resultar beneficiada con la terapia suplementaria de oxígeno. Su cuerpo requiere un suministro estable de oxígeno para funcionar apropiadamente. Su médico le prescribió un suplemento de oxígeno debido a que no está recibiendo suficiente oxígeno del aire del cuarto. El suplemento de oxígeno aumentará la cantidad de oxígeno que su cuerpo recibe.

El suplemento de oxígeno no crea adicción. Su médico le prescribió un flujo específico de oxígeno para corregir síntomas como dolor de cabeza, somnolencia, confusión, fatiga o aumento de irritabilidad. Si estos síntomas persisten después de iniciar el programa de suplemento de oxígeno, consulte a su médico.

### **Cómo funciona su Concentradores de Oxígeno DeVilbiss**

Los concentradores de oxígeno son la fuente de suplemento de oxígeno más confiable, eficiente y conveniente que se puede conseguir hoy en día. El concentrador se opera eléctricamente. La unidad separa el oxígeno del aire del cuarto lo que le permite tener un suplemento de oxígeno de alta pureza proporcionado a Ud. a través del orificio de oxígeno. Aunque el concentrador filtra el oxígeno del cuarto, no afectará la cantidad normal de oxígeno en su cuarto.

## PARTES IMPORTANTES DE SU CONCENTRADOR

Sírvase tomarse un momento para familiarizarse con su concentrador de oxígeno DeVilbiss antes de usarlo.

### Vista frontal

1. Instrucciones para el funcionamiento
2. Luz verde de encendido- se ilumina cuando su concentrador está funcionando.
3. Interruptor de encendido  
| = ON  
O = OFF
4. Perilla del medidor de flujo
5. Medidor de flujo
6. Cortacircuitos - (unidades seleccionadas) reinicializa la unidad después de un apagado por exceso de corriente eléctrica.
7. Salida de oxígeno - el oxígeno se dispersa a través de este orificio.
8. Luz (verde) de oxígeno normal - DeVilbiss Concentradores de Oxígeno OSD solamente (vea la página 14).
9. Luz (amarilla) de oxígeno bajo - DeVilbiss Concentradores de Oxígeno OSD solamente (vea la página 14).
10. Luz roja de necesidad de servicio - cuando se enciende contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss.

### Vista posterior

11. Normas de seguridad importantes
12. Manija
13. Escape
14. Cordón eléctrico y/o Conector de suministro IEC (siglas en inglés de "Comisión Electrotécnica Internacional").
15. Tira de cordón recto
16. Filtro de aire - evita la entrada de suciedad, polvo y pelusa a su unidad.

### Accesorios

Los accesorios a continuación están aprobados para usarse con los Concentradores de Oxígeno DeVilbiss:

Humidificador de Burbuja (capacidad de 200 ml): 50/estuche .....	HUM16
Cánula (desechable): 50 / estuche .....	CAN00
Cánula c/2,1 m (7 pies) Conducto para Oxígeno (desechable): 50 / estuche .....	CAN70
Conector de Salida de Oxígeno:	
Plástico; 1 / paquete .....	CN100
Conducto de Oxígeno (desechable):	
2,1 m (7 pies); 50/estuche.....	OST07
4,2 m (14 pies); 50/estuche.....	OST15
7,5 m (25 pies); 25/estuche.....	OST25
15 m (50 pies); 15/estuche.....	OST50

**NOTA**– El uso de ciertos humidificadores y accesorios no especificados anteriormente puede impedir el funcionamiento del concentrador de oxígeno.

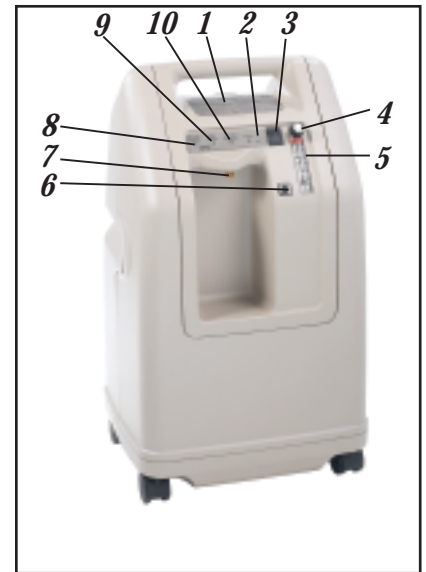


Figura 1

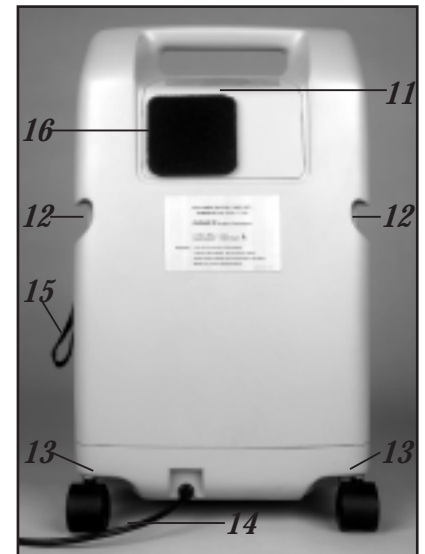


Figura 2

**PREPARACIÓN DE SU CONCENTRADOR DE OXÍGENO**

1. Coloque su unidad cerca de un tomacorriente en el cuarto donde está la mayor parte del tiempo.

**⚠ ADVERTENCIA**

**Mantenga el concentrador de oxígeno por lo menos 1,6 metros (5 pies) de objetos calientes o que producen chispas, y de fuentes de llama descubiertas.**

**NOTA**– No lo conecte a un tomacorriente que se controla por medio de un interruptor de pared.

Ningún otro aparatos se debe conectar al tomacorriente de pared.

2. Coloque su unidad a por lo menos 16cm (6 pulgadas) de paredes, cortinas o de cualquier otro objeto que pudiera impedir el flujo apropiado de aire hacia adentro y hacia afuera de su concentrador de oxígeno. El concentrador de oxígeno debe localizarse en lugares donde no haya contaminantes ni humos.

**ANTES DE USAR SU CONCENTRADOR**

1. Antes de usar su unidad, revise siempre que el filtro de aire (ubicado en la parte posterior de su unidad) esté limpio. La limpieza apropiada para este filtro se discute en la sección Cuidado de su Concentrador en la página 15.

2. Conecte los accesorios de oxígeno apropiados a la salida de oxígeno.

**Conexión del tubo de oxígeno:**

- a. Atornille el conector de salida de oxígeno en la salida de oxígeno.
- b. Fije directamente el conducto de oxígeno al conector **Figura 3**.

**Conexión tubo de oxígeno con humidificación:**

Si su médico le ha prescrito un humidificador de oxígeno como parte de su terapia, siga estos pasos:

- a. Llene la botella del humidificador con agua destilada. No llene en exceso. (Si utiliza un prellenado, refiérase al inciso b.)
  - b. Enrosque la tuerca de mariposa ubicada en la parte superior de la botella del humidificador en la salida de oxígeno de tal manera que quede fija **Figura 4**. Asegúrese que esté apretada.
  - c. Conecte el tubo de oxígeno directamente a la unión de la salida de la botella del humidificador **Figura 5**.
3. Su médico le ha prescrito una cánula nasal, catéter o una mascarilla facial. En la mayoría de los casos, vienen conectados ya en el tubo de oxígeno. En caso de que no lo estén, siga las instrucciones del.
  4. Saque el cordón de suministro por completo de la tira de cordón recto. Asegúrese que el interruptor de encendido esté apagado "Off," y enchufe la clavija en el tomacorriente de pared. La unidad está doblemente aislada para protegerla contra choques eléctricos.

**NOTA**– (Sólo en los unidades de 115 Volts) La clavija del concentrador tiene una espiga más ancha que la otra. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija se debe conectar a un tomacorriente de pared solamente de una manera. No intente modificar esta característica de seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA**

**El uso inapropiado del cordón de suministro y de las clavijas puede causar quemaduras, incendios y riesgos de choque eléctrico. No use la unidad si el cordón de suministro está deteriorado.**


**USO DE SU CONCENTRADOR****⚠ PELIGRO**

**El oxígeno se quema rápidamente. No fume cuando esté usando su concentrador de oxígeno o cuando esté cerca de una persona que esté bajo terapia de oxígeno. Mantenga el concentrador de oxígeno a por lo menos 1,6m (5 pies) de objetos calientes, con chispas o de fuentes de llamas.**

**⚠ PELIGRO**

**No coloque la cánula hacia abajo mientras el concentrador está administrando oxígeno. Las altas concentraciones de oxígeno pueden provocar quemaduras rápidamente.**

1. Encienda el interruptor de encendido "On." Cuando la unidad se enciende, la luz de encendido se ilumina y el sistema de alerta del paciente - la luz de necesidad de servicio y la señal auditiva -se encenderá brevemente.

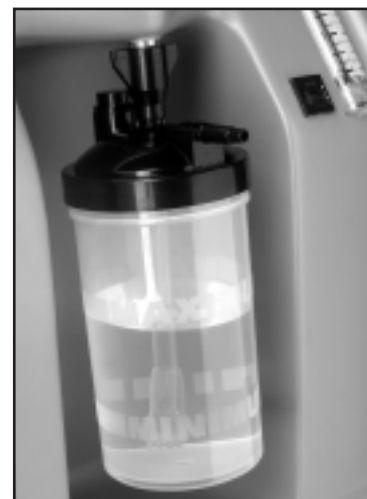**Figura 3****Figura 4****Figura 5**

**DEVILBISS CONCENTRADORS DE OXÍGENO OSD SOLAMENTE**

El OSD (siglas en inglés de “Aparato Detector de Oxígeno”) es un aparato dentro de su concentrador que monitorea el oxígeno producido en su unidad. Cuando la unidad se enciende “On,” las cuatro luces (encendido, necesidad de servicio, bajo oxígeno y oxígeno normal) en el panel frontal se iluminarán brevemente. Después de algunos segundos, solamente las luces de encendido y de oxígeno normal quedarán encendidas.

Las luces del OSD del panel frontal se especifican como sigue:

- Luz verde de oxígeno normal – nivel de oxígeno aceptable.
- Luz amarilla de bajo oxígeno – por debajo del nivel de oxígeno aceptable.

Si la pureza del oxígeno cae por debajo del nivel de oxígeno aceptable, la luz verde de oxígeno normal se apagará y se encenderá la luz amarilla de bajo oxígeno. Utilice su sistema de reserva de oxígeno. Consulte la sección de Detección y solución de problemas menores OSD en la página 16 de esta guía y contacte a su proveedor de Sunrise Medical/DeVilbiss.

Como una característica de seguridad adicional, en caso de que la pureza del oxígeno continúe descendiendo, una señal auditiva sonará intermitentemente. Contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss inmediatamente. No realice ningún otro mantenimiento.

**NOTA**– Si la luz de Necesidad de Servicio se ilumina y la señal auditiva suena pero la unidad no está funcionando, la unidad no tiene energía. Consulte la Tabla de detección y solución de problemas menores en la página 16 y contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss de ser necesario.

**NOTA**– La unidad no funciona correctamente, si se percibe un sonido vibratorio de baja frecuencia. Remítase a la tabla sobre Detección y Solución de Problemas Menores de la página 16, y póngase en contacto con su proveedor de Sunrise Medical/DeVilbiss si fuera necesario.

2. Revise la medidor de flujo para cerciorarse que la bola del medidor de flujo está centrada en la línea junto al número de su flujo prescrito.

**PRECAUCION**– Es muy importante seguir su prescripción de oxígeno. No aumente ni disminuya el flujo de oxígeno - consulte a su médico.

**NOTA**– Su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss puede haber prefijado el medidor de flujo de tal forma que no se pueda cambiar.

**NOTA**– Si la perilla del medidor de flujo se gira en sentido de las manecillas del reloj, el flujo disminuirá (y eventualmente cerrará el suministro de oxígeno). Si la perilla se gira en sentido contrario de las manecillas del reloj, el flujo aumentará.

**NOTA**– La alarma de flujo bajo se activará si la bola del medidor de flujo está ajustada a menos de 0.3 lpm. La unidad continuará funcionando; sin embargo, la luz de aviso de Mantenimiento requerido se encenderá y sonará la alarma audible. Ajuste el medidor de flujo de acuerdo con el flujo prescrito.

3. Su concentrador DeVilbiss está ahora listo para usarse, coloque la cánula o la mascarilla apropiadamente **Figura 6**. Espere 20 minutos para que el concentrador de oxígeno alcance el funcionamiento previsto.

**SISTEMA DE OXÍGENO DE RESERVA**

Como precaución, su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss le debe proporcionar un sistema de oxígeno de reserva. En caso de falta de suministro de corriente o que la unidad tuviera alguna falla, el sistema de alerta del paciente sonará para avisarle que utilice el sistema de oxígeno de reserva (si está provisto) y contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss.



**Figura 6**



**CUIDADO DE SU DEVILBISS CONCENTRADORS DE OXÍGENO**

**NOTA**– No use lubricantes, aceites ni grasas.

**⚠ ADVERTENCIA**

Antes de realizar los procedimientos de limpieza apague la unidad “Off.”

**Humidificador de oxígeno (Botellas reusables)**

Si su médico le ha prescrito humidificación, limpie la botella del humidificador diariamente. Siga las instrucciones que le provee el fabricante. Si no se proporcionaron las instrucciones de limpieza, siga los siguientes pasos:

1. Lave el humidificador en una solución de agua caliente y detergente lavaplatos **Figura 7**.
2. Remoje el humidificador en una solución de una parte de vinagre blanco con tres partes de agua caliente durante 30 minutos **Figura 8**. Esta solución actúa como un agente germicida.
3. Enjuáguelo bien con agua caliente del grifo y llénelo con agua destilada **Figura 9** para usarlo. No llene en exceso.

**Cánula, Mascarilla y Tubos**

Limpie y reemplace la cánula, mascarilla y tubos como le ha enseñado su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss.

**Filtro de Aire y Conector de Salida de Oxígeno**

El filtro de aire y el conector deben limpiarse por lo menos una vez a la semana. Para limpiarlos, siga los pasos siguientes:

1. Quite el filtro de aire, ubicado en la parte posterior de la unidad. Quite el conector de salida del oxígeno (si se usa).
2. Lávelos en una solución de detergente y agua tibia. **Figura 10**.
3. Enjuague bien con agua tibia del grifo y seque con una toalla. El filtro debe estar completamente seco antes de reinstalarlo.

**PRECAUCION**– Para prevenir que el producto se dañe, no trate de hacer funcionar la unidad sin el filtro de aire o cuando el filtro está aún húmedo.

**Cubierta Exterior****⚠ ADVERTENCIA**

Para evitar un choque eléctrico no quite la cubierta del concentrador. Solamente un técnico calificado de Sunrise Medical/DeVilbiss debe quitar la cubierta. No aplique el líquido directamente en la cubierta ni utilice ningún solvente derivado del petróleo o agentes limpiadores.

Limpie la cubierta exterior del concentrador usando un paño o esponja humedecida con un limpiador de uso doméstico suave y séquela.



**Figura 7**



**Figura 8**



**Figura 9**



**Figura 10**



**DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

La tabla siguiente para la detección y solución de problemas lo ayudará a analizar y corregir malfuncionamientos menores del concentrador de oxígeno. Si los procedimientos sugeridos no ayudan, utilice su sistema de oxígeno de reserva y llame a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss de cuidado en el hogar. No realice ningún otro mantenimiento.

**⚠ ADVERTENCIA**

**Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la cubierta. Solamente un técnico calificado de Sunrise Medical/DeVilbiss de cuidado en el hogar debe quitarla.**

**TABLA DE DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MENORES**

Sintoma	Causa Posible	Solución
A. La unidad no funciona. La luz de encendido está apagada cuando el interruptor de encendido está encendido. La alarma audible está sonando y la luz de necesidad de servicio está parpadeando.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cordón de suministro no está apropiadamente conectado en el tomacorriente de la pared.</li> <li>2. El tomacorriente no pasa corriente.</li> <li>3. El cortacircuitos del concentrador de oxígeno está activado (unidades seleccionadas).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise la conexión en el tomacorriente de pared. En los unidades de 230 volts, también revise el conector del cordón de suministro en la parte posterior de la unidad.</li> <li>2. Revise el cortacircuitos de su casa y reactivélo si es necesario. Use un tomacorriente diferente si ocurre de nuevo.</li> <li>3. Pulse el botón de reposición del cortacircuitos del concentrador (si lo hubiera) ubicado debajo del interruptor de encendido. Use un tomacorriente diferente si ocurre de nuevo. Si las soluciones anteriores no funcionan, contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>
B. La unidad funciona, la luz de encendido está encendida cuando el interruptor de encendido está encendido "On." La luz de necesidad de servicio está encendida. Alarma auditiva puede sonar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El filtro de aire está bloqueado.</li> <li>2. El escape está bloqueado.</li> <li>3. Cánula, catéter, mascarilla facial o los tubos de oxígeno están bloqueados o defectuosos.</li> <li>4. La botella del humidificador está bloqueada o defectuosa.</li> <li>5. El medidor de flujo está prefijado demasiado bajo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise el filtro de aire. Si el filtro está sucio, lávelo siguiendo las instrucciones de limpieza de la página 15.</li> <li>2. Revise el área del escape; asegúrese que no hay nada que obstruya el escape de la unidad.</li> <li>3. Quite la cánula, el catéter o la mascarilla facial. Si el flujo se restaura apropiadamente, limpie o reemplace en caso necesario. Desconecte los tubos de oxígeno de la salida de oxígeno. Si el flujo se restaura apropiadamente, revise que los tubos de oxígeno no estén obstruidos ni doblados, reemplácelos en caso necesario.</li> <li>4. Quite el humidificador de la salida de oxígeno. Si se obtiene un flujo apropiado, limpie o reemplace el humidificador.</li> <li>5. Prefije el medidor de flujo al valor prescrito. Si las soluciones anteriores no funcionan, contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>
C. La unidad está en funcionamiento, el piloto de la corriente se enciende cuando se acciona el interruptor, y se percibe un sonido vibratorio de baja frecuencia.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apague su unidad "Off." Utilice su sistema de oxígeno de reserva y contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss inmediatamente.</li> </ol>
D. Si ocurren otros problemas en su concentrador de oxígeno.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apague su unidad "Off." Utilice su sistema de oxígeno de reserva y contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss inmediatamente.</li> </ol>

**TABLA DE DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MENORES OSD - SOLAMENTE CONCENTRADORES OSD**

Luces de Indicadores Visuales	Causa Posible	Solución
A. Ambas luces, verde de oxígeno normal y amarilla de bajo oxígeno están encendidas o apagadas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malfuncionamiento del OSD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>
B. La luz amarilla de bajo oxígeno está encendida o la luz amarilla de bajo oxígeno está encendida y la señal auditiva está sonando intermitentemente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El medidor de flujo no está prefijado apropiadamente.</li> <li>2. El filtro de aire está bloqueado.</li> <li>3. El escape está bloqueado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese que el medidor de flujo esté apropiadamente prefijado al valor prescrito.</li> <li>2. Revise el filtro de aire. Si el filtro está sucio, lávelo siguiendo las instrucciones de limpieza de la página 15.</li> <li>3. Revise el área del escape; cerciórese que nada obstruye el escape de la unidad. Si las soluciones anteriores no funcionan, contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>
C. La luz de Necesidad de Servicio Rojo está iluminada y está sonando una alarma audible intermitente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El medidor de flujo no está prefijado apropiadamente.</li> <li>2. El filtro de aire está bloqueado.</li> <li>3. El escape está bloqueado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese que el medidor de flujo esté apropiadamente prefijado al valor prescrito.</li> <li>2. Revise el filtro de aire. Si el filtro está sucio, lávelo siguiendo las instrucciones de limpieza de la página 15.</li> <li>3. Revise el área del escape; cerciórese que nada obstruye el escape de la unidad. Si las soluciones anteriores no funcionan, contacte a su proveedor Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>

## ESPECIFICACIONES

<b>SERIE DE 5 LITROS DE DEVILBISS</b>	
<b>Número de Catálogo</b>	<b>515ADS, 515ADZ</b>
<b>Rapidez de Suministro</b> (Velocidades de suministro más bajas disponibles para aplicaciones de flujo bajo)	1 to 5 LPM
<b>Flujo Máximo Recomendado</b>	5 LPM
<b>Presión de Salida</b>	8.5 psig (58.6 kPa)
<b>Clasificación Eléctricos</b>	115 V, 60 Hz, 4.1 Amp
<b>Rango de Voltaje de Operación</b>	97-127 V-, 60 Hz
<b>Porcentaje de Oxígeno</b>	1-5 LPM=93%±3%
<b>Altitud de Operación</b> (probado solamente a 21°C) 0-1500 M (0-4921 ft)  1500-3000 M (4921-9842 ft) 3000-4000 M (9842-13123 ft)	<p><i>A través el rango de voltaje:</i> No disminuye el rendimiento</p> <p><i>Probado a voltaje nominal solamente:</i> No se espera una degradación del desempeño con base en las pruebas realizadas en un producto similar. No recomendado/No probado</p>
<b>Ambiente de Operación*</b> De 10°C a 35°C, rango de humedad de 30% a 75%	No disminuye el rendimiento a través del rango de voltaje de operación (probado a nivel del mar).
<b>Consumo de Energía</b>	385 Watts Average 515ADS solamente -- 320 vatios a 2.5 lpm y niveles menores
<b>Peso</b>	22.7 Kilograms (50 lbs.)
<b>Nivel de Ruido</b> (ISO 8359:1996 de la parte anterior)	48.0 dbA promedio total**
<b>Dimensiones</b>	27.75"H x 16"W x 14"D (70.5 x 40.6 x 35.6 cm)
<b>Válvula de Alivio de Presión</b>	40 psig±5psig (276 kPa±34.5 kPa)
<b>Sistema de Operación</b>	Oscilación de Presión / Cronometrada
<b>Para unidades equipadas con un OSD, el indicador visual de "Bajo Oxígeno" se activará a los siguientes niveles de concentración</b>	84%±2% (La alarma sonora alertará cuando haya un 75% aproximadamente. A menos de 60%, la luz roja de "servicio requerido" se activará.)
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	De -40°C a 70°C, rango de humedad de 10% a 100%, incluir condensación
<b>Clase y Tipo de Equipo</b>	<input type="checkbox"/> Equipo de Clase II con Aislamiento Doble <input checked="" type="checkbox"/> Parte Aplicada de Tipo B
<b>Órgano de Aprobación y Norma de Seguridad</b>	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90
<b>Acatamiento de EMC a:</b>	IEC 60601-1-2

\*Nota: El desempeño del ASO de 10° C a 35° C, 95% H.R., voltaje de paso en el 515ADS verificado a 670m.  
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

**TABLE DES MATIÈRES**

Mises en Garde Importantes.....	19
Introduction .....	19
Pourquoi Votre Médecin Vous a-t-il Prescrit un Supplément d'Oxygène.....	19
Comment Fonctionne Votre Concentrateurs.....	19
Pièces Importantes de Votre Appareil Concentrateur.....	20
Installation de Votre Appareil .....	21
Avant d'Utiliser Votre Concentrateur.....	21
Utilisation de Votre Concentrateur .....	21
Réserve d'Oxygène.....	22
Entretien de Votre Appareil Concentrateur.....	23
Dépannage .....	24
Caractéristiques .....	25
Déclaration de Conformité .....	25

**ATTENTION**– En vertu de la Loi fédérale américaine, la vente de cet appareil n'est autorisée que par un médecin ou sur ordonnance de ce dernier.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**– Le “Concentrateur d'oxygène DeVilbiss” est conçu pour être utilisé comme concentrateur d'oxygène, pour administrer un supplément d'oxygène de faible débit à des fins thérapeutiques à domicile, aux foyers de soins infirmiers, aux installations et services de soins aux patients etc.

### **▲ AVERTISSEMENT**

Dans certaines circonstances, l'oxygénothérapie peut être dangereuse. L'obtention de conseils médicaux est recommandée avant d'utiliser le concentrateur d'oxygène.

#### **Renseignements relatifs au médecin**

Nom du médecin: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

#### **Renseignements relatifs à la prescription**

Nom: \_\_\_\_\_

Litres d'oxygène par minute

Au repos: \_\_\_\_\_ En activité: \_\_\_\_\_

Autre: \_\_\_\_\_

#### **Utilisation quotidienne d'oxygène:**

Heures: \_\_\_\_\_ Minutes: \_\_\_\_\_

Commentaires: \_\_\_\_\_

**Concentrateur d'oxygène DeVilbiss Numéro de série:** \_\_\_\_\_

(Cochez un modèle)

5-Liter       5-Liter with OSD       \_\_\_\_\_


#### **Données sur le prestataire de service**

Nom de la personne qui a installé l'appareil: \_\_\_\_\_

Ce guide d'instructions a été révisé en ma présence et j'ai reçu les directives sur l'utilisation sécuritaire et les soins à apporter au concentrateur d'oxygène DeVilbiss.

Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

*Augmenter*

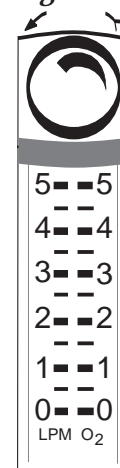

*DeVilbiss 5-Liter Series*

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

**▲** Veuillez lire entièrement le guide avant d'utiliser votre concentrateur DeVilbiss. Les renseignements importants sont précédés des termes suivants afin d'attirer votre attention:

- DANGER** Informations d'identification des dangers susceptibles de provoquer des blessures graves ou un accident mortel.
- AVERTISSEMENT** Mesures de sécurité en cas de dangers pouvant entraîner une blessure grave.
- ATTENTION** Renseignements visant à prévenir tout dommage à l'appareil.
- REMARQUE** Veuillez apporter une attention particulière à ces renseignements.

Les mises en garde importantes sont mentionnées dans ce guide; faites particulièrement attention aux renseignements relatifs à la sécurité.



**DANGER—NE PAS FUMER**

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

### INTRODUCTION

Ce guide vous familiarisera avec le concentrateur d'oxygène DeVilbiss. Prenez le temps de bien lire et comprendre ce guide avant d'utiliser votre appareil. Les mises en garde importantes sont mentionnées dans ce guide; faites particulièrement attention aux renseignements relatifs à la sécurité. Contactez votre fournisseur d'appareils médicaux si vous avez d'autres questions.

### **▲ AVERTISSEMENT**

**Pour votre propre sécurité, le concentrateur d'oxygène doit être utilisé selon la prescription de votre médecin.**

### **▲ DANGER**

**L'oxygène peut brûler rapidement. Ne fumez pas lorsque votre concentrateur d'oxygène est en marche ou si vous êtes près d'une personne qui a recours à une thérapie d'oxygène. Ne l'utilisez pas à moins de 5 pieds (1,6m) d'objets qui sont chauds ou qui font des étincelles ou de sources de flammes vives.**

### **Pourquoi votre médecin vous a-t-il prescrit un supplément d'oxygène**

De nos jours un grand nombre de personnes sont victimes de maladies cardiaques, pulmonaires ou d'autres maladies respiratoires. La plupart de ces personnes peuvent bénéficier d'une thérapie de supplément d'oxygène. Votre corps requiert un apport régulier d'oxygène pour bien fonctionner. Votre médecin vous a prescrit un supplément d'oxygène parce que l'air de la pièce ne vous fournit pas suffisamment d'oxygène. Le supplément d'oxygène augmentera la quantité d'oxygène que recevra votre corps.

Le supplément d'oxygène ne crée pas de dépendance. Votre médecin a prescrit un débit précis d'oxygène pour diminuer des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue ou une irritabilité accrue. Si ces symptômes persistent une fois que vous avez commencé votre programme de supplément d'oxygène, veuillez consulter votre médecin.

### **Comment fonctionne votre Concentrateurs d'oxygène DeVilbiss**

Les concentrateurs d'oxygène sont les sources de supplément d'oxygène les plus fiables, efficaces et pratiques disponibles sur le marché. Le concentrateur est électrique. L'appareil sépare l'oxygène de l'air de la pièce; par conséquent, le supplément d'oxygène distribué par le port d'oxygène est d'une plus grande pureté. Même si le concentrateur filtre l'oxygène de la pièce, il n'affectera pas le volume normal d'oxygène de votre pièce.

## PIÈCES IMPORTANTES DE VOTRE APPAREIL CONCENTRATEUR

Veillez prendre le temps de vous familiariser avec votre concentrateur d'oxygène DeVilbiss avant de l'utiliser.

### Partie avant

1. Instructions d'utilisation
2. Voyant vert – s'allume lorsque l'appareil est en marche.
3. Interrupteur d'alimentation  
| = ON  
O = OFF
4. Bouton du débitmètre
5. Débitmètre
6. Disjoncteur – (Unités sélectionnées) Remet l'appareil sous tension après une surcharge électrique.
7. Sortie d'oxygène – l'oxygène est dispersée par ce port.
8. Niveau normal d'oxygène (voyant vert) – SEULEMENT pour les appareils munis d'un appareil détecteur d'oxygène OSD® (voir page 22).
9. Bas niveau d'oxygène (Voyant jaune) – SEULEMENT pour les appareils munis d'un OSD® (voir page 22).
10. Voyant Rouge "Service Required" – Contactez votre prestataire si le voyant est allumé.

### Vue arrière

11. Mises en garde importantes
12. Poignée
13. Échappement
14. Cordon d'alimentation et/ou Connexion CEI.
15. Cordon électrique
16. Filtre à air - Empêche la saleté, la poussière et les flocons de poussière de pénétrer dans votre appareil.

### Accessoires

Les accessoires ci-dessous sont approuvés pour être utilisés avec les concentrateurs d'oxygène de DeVilbiss:

Humidificateur à bulles (contenance de 200 mL): 50/caisse .....	HUM16
Canule (jetable): 50/caisse.....	CAN00
Canule avec tube à oxygène de 2,1 m (7 pi) (jetable): 50/caisse .....	CAN70
Raccord de sortie à oxygène:	
plastique, 1/sac .....	CN100
Tube à oxygène (jetable):	
2,1 m (7 pi), 50/caisse .....	OST07
4,2 m (14 pi), 50/caisse .....	OST15
7,5 m (25 pi), 25/caisse .....	OST25
15 m (50 pi), 15/caisse .....	OST50

**REMARQUE**– L'utilisation de certains humidificateurs et accessoires non mentionnés ci-dessus peut nuire au rendement du concentrateur d'oxygène.

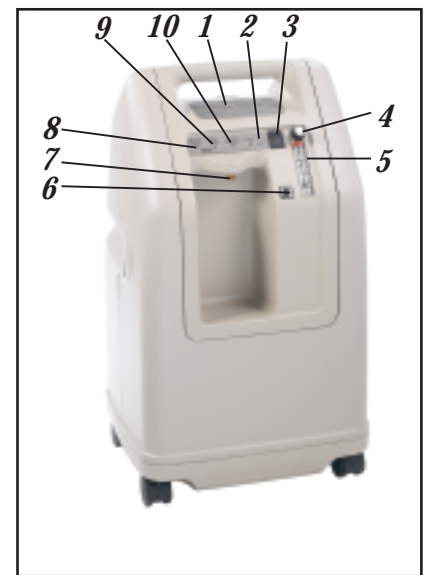


Figure 1



Figure 2

**INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE**

1. Placez votre concentrateur d'oxygène dans la pièce où vous consacrez la plupart de votre temps.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Tenez le concentrateur d'oxygène à au moins 1,6 mètre (5 pieds) d'objets qui sont chauds ou qui font des étincelles ou de sources de flammes vives.

**REMARQUE**– Ne branchez pas votre appareil à une sortie électrique commutée par un interrupteur mural. Aucun autre appareil électrique ne devrait être branché dans la prise de courant murale.

2. Placez votre appareil à au moins 16cm des murs, draperies ou de tout autre objet qui pourrait nuire au débit entrée/sortie de votre concentrateur d'oxygène. Le concentrateur d'oxygène devrait être placé de façon telle à éviter les produits polluants ou les vapeurs.

**AVANT D'UTILISER VOTRE CONCENTRATEUR**

1. Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous de toujours vérifier si le filtre à air (situé à l'arrière de votre appareil) est propre. La procédure de nettoyage de ce filtre est traité à la section Entretien de votre appareil concentrateur à la page 23.

2. Fixez les accessoires d'oxygène appropriés à la sortie d'oxygène.

**Connexion du tube d'oxygène:**

- a. Vissez le raccord de sortie à oxygène à la sortie à oxygène.
- b. Attachez le tube à oxygène directement au raccord **Figure 3**.

**Connexion du tube d'oxygène à l'humidificateur:**

Si votre médecin a inclus un humidificateur dans votre thérapie, veuillez suivre les étapes suivantes:

- a. Remplissez la bouteille de l'humidificateur avec de l'eau distillée. Évitez de trop remplir. (Si vous utilisez une bouteille pré-remplie, passez à la lettre b.)
  - b. Vissez l'écran papillon situé sur le dessus de la bouteille de l'humidificateur à la sortie d'oxygène afin que la bouteille soit suspendue **Figure 4**. Assurez-vous qu'elle est bien serrée.
  - c. Fixez le tube d'oxygène directement au raccord de sortie de la bouteille de l'humidificateur **Figure 5**.
3. Votre médecin vous a prescrit soit une canule nasale, soit un cathéter ou un masque facial. Dans la plupart des cas, ils sont déjà attachés au tube d'oxygène. Dans le cas contraire, veuillez suivre les directives du fabricant.
  4. Retirez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position "Off" et insérez la fiche dans la prise murale. L'appareil est doté d'une double isolation pour protéger contre tout choc électrique.

**REMARQUE**– (Appareils à 115 volts seulement) Le concentrateur est muni d'une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque d'électrocution. Cette fiche est conçue pour s'insérer dans une sortie à sens unique seulement. N'essayez pas de dévier cet élément de sécurité.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Une utilisation inadéquate du cordon d'alimentation et des prises peut causer un incendie ou d'autres dangers de nature électrique. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.

**UTILISATION DE VOTRE CONCENTRATEUR****⚠ DANGER**

L'oxygène peut brûler rapidement. Ne fumez pas lorsque votre concentrateur d'oxygène est en marche ou si vous êtes près d'une personne qui a recours à une thérapie d'oxygène. Maintenez le concentrateur à un minimum de 5 pieds (1,6 m) de la chaleur, des objets provoquant des étincelles ou de toute source inflammable à air libre.

**⚠ DANGER**

Ne posez pas la canule à plat pendant que le concentrateur fournit de l'oxygène. Une concentration élevée d'oxygène peut causer une inflammation rapide.

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position "On." Lorsque vous mettez l'appareil sous tension "On," le voyant s'allumera, le système d'alarme du patient - "Service Required" s'allumera et un bref signal sonore se déclenchera.



Figure 3



Figure 4



Figure 5



**DEVILBISS CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE AVEC OSD SEULEMENT**

L'OSD (appareil détecteur d'oxygène) est un mécanisme incorporé dans votre concentrateur, qui surveille l'oxygène produit par votre appareil. Lorsque vous mettez votre appareil en marche "On," les quatre voyants (alimentation, entretien, bas niveau d'oxygène et niveau normal d'oxygène) sur le panneau avant s'allument brièvement. Après quelques secondes, seuls les voyants Power (alimentation) et Normal Oxygen (niveau normal d'oxygène) resteront allumés. Les voyants l'OSD sur le panneau avant sont définis comme suit:

- Le voyant vert Normal Oxygen (Niveau normal d'oxygène)– accepte le niveau d'oxygène.
- Le voyant jaune Low Oxygen (Bas niveau d'oxygène)– Sous le niveau d'oxygène acceptable.

Si la pureté s'oxygène descend sous le niveau thérapeutique jugé acceptable, le voyant vert Normal Oxygen s'éteindra et le vert jaune Low Oxygen s'allumera. Utilisez votre système d'oxygène de réserve. Référez-vous à la section Dépannage mineur concentrateurs munis de l'OSD à la page 24 de ce guide, et contactez votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.

Au cas où le niveau de concentration d'oxygène s'abaisserait davantage, un signal sonore intermittent se déclenche. Veuillez communiquer immédiatement avec votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss. N'essayez pas de solutionner le problème.

**REMARQUE**– Si le témoin "Service Required" s'allume et qu'on entend l'alarme sonore sans que l'appareil fonctionne, cela signifie que l'appareil n'est pas alimenté en courant. Se reporter au Tableau de Dépannage Mineur à la page 24 et, si nécessaire, contacter le fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.

**REMARQUE**– Si un son audible basse fréquence est détecté, l'appareil ne fonctionne pas de manière appropriée. Reportez-vous au tableau de dépannage mineur page 24 ou contactez votre fournisseur d'appareils Sunrise Medical/DeVilbiss.

2. Vérifiez le débitmètre pour vous assurer que la bille du débitmètre est centrée sur la ligne près du niveau prescrit.

**ATTENTION**– Il est primordial de suivre le niveau d'oxygène prescrit. N'augmentez pas ou ne diminuez pas le débit d'oxygène. Consultez votre médecin.

**REMARQUE**– Il est possible que votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss ait pré-réglé le débitmètre de façon à ce qu'il ne puisse pas être ajusté.

**REMARQUE**– Si le bouton du débitmètre est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, le débit diminue (se coupera éventuellement). Si le bouton est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le débit augmente.

**REMARQUE**– L'alarme de faible débit s'active si la bille du débitmètre est réglée à moins de 0,3 lpm. L'appareil continuera à fonctionner, cependant, l'indicateur d'entretien nécessaire s'allume accompagné d'une alarme sonore. Réglez le débitmètre en fonction du débit prescrit.

3. Vous pouvez maintenant utiliser votre concentrateur DeVilbiss. Assurez-vous de bien placer la canule ou le masque **Figure 6**. Donnez 20 minutes au concentrateur d'oxygène pour qu'il atteigne son rendement nominal.

**RÉSERVE D'OXYGÈNE**

Comme mesure de précaution, votre fournisseur peut vous fournir une réserve d'oxygène. Si votre concentrateur d'oxygène est interrompu par une panne ou ne fonctionne pas correctement, un avertisseur sonore vous demandera d'utiliser votre système de rechange (si vous en avez un) et de contacter votre prestataire.



*Figure 6*



**ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL DEVILBISS CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE**

**REMARQUE**– N'utilisez aucun lubrifiant, huile ou graisse.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Avant de commencer toute procédure de nettoyage, veuillez mettre l'appareil sur "Off."

**Humidificateur d'oxygène (bouteilles réutilisables)**

Si votre médecin vous a prescrit un humidificateur, nettoyez quotidiennement la bouteille de l'humidificateur. Si aucune directive de nettoyage n'a été fournie, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Lavez l'humidificateur avec une solution d'eau chaude et un détergent à vaisselle **Figure 7**.
2. Trempez dans une solution composée d'une partie de vinaigre blanc et trois parties d'eau chaude pendant 30 minutes **Figure 8**. Cette solution agit comme agent antiseptique.
3. Rincez bien sous le robinet d'eau chaude et remplissez à nouveau d'eau distillée **Figure 9**. Évitez de trop remplir.

**Canule, masque ou tube**

Nettoyez et remplacez la canule, le masque et le tube selon les directives de votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.

**Filtre à air et raccord de sortie à oxygène**

Le filtre à air et le raccord de sortie à oxygène devraient être nettoyés au moins une fois par semaine. Pour les nettoyer, procédez de la manière suivante :

1. Retirez le filtre à air situé à l'arrière de l'appareil. Retirez le raccord de sortie à oxygène (s'il est utilisé).
2. Lavez dans une solution d'eau tiède et de détergent **Figure 10**.
3. Rincez bien sous le robinet d'eau chaude et asséchez bien avec une serviette. Assurez-vous que le filtre soit complètement sec avant de l'installer à nouveau.

**ATTENTION**– Dans le but de ne pas endommager votre appareil, n'essayez pas de l'utiliser sans le filtre à air ou si le filtre est encore humide.

**Coque Extérieure****⚠ AVERTISSEMENT**

Pour éviter tout choc électrique, n'enlevez pas le coque du concentrateur. Seul un technicien qualifié de Sunrise Medical/DeVilbiss doit enlever le coque. N'appliquez aucun liquide directement sur le coque ou n'utilisez aucun dissolvant ou agent nettoyant à base de pétrole.

Nettoyez l'extérieur du coque avec un linge humide ou une éponge et un nettoyant de maison doux, et séchez-le.




*Figure 7*



*Figure 8*



*Figure 9*

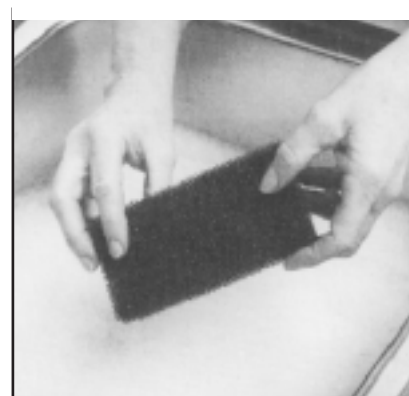

*Figure 10*

## DÉPANNAGE

Le tableau suivant vous sert de guide pour analyser et corriger les défaillances mineures de votre concentrateur d'oxygène. Si les procédures suggérées ne remettent pas votre appareil en condition normale d'utilisation, utilisez votre réserve d'oxygène et appelez votre fournisseur d'appareils Sunrise Medical/DeVilbiss. N'essayez pas d'effectuer des opérations d'entretien.

### ▲ AVERTISSEMENT

**Ne retirez pas le coque afin d'éviter tout choc électrique. Le coque ne peut être enlevé que par un technicien Sunrise Medical/DeVilbiss.**

#### TABLEAU DE DÉPANNAGE MINEUR

Symptômes	Cause Possible	Solution
A. L'appareil ne fonctionne pas. Le voyant d'alimentation est à "Off" lorsque l'interrupteur est à "On." Un avertisseur sonore émettra des impulsions et le voyant "Service Required" cliquète.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le cordon d'alimentation n'est pas bien inséré dans la prise murale.</li> <li>2. Il n'y a pas d'alimentation dans la prise murale.</li> <li>3. Le disjoncteur du concentrateur d'oxygène est activé (Unités sélectionnées).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez le cordon d'alimentation et la connexion dans la prise murale. Appareils à 230 volts-vérifiez également la connexion du cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil.</li> <li>2. Vérifiez le disjoncteur de du circuit de votre maison et remettez l'appareil en marche, au besoin.</li> <li>3. Appuyer sur le bouton de réenclenchement du disjoncteur du concentrateur (s'il est installé) situé sous l'interrupteur. Utilisez une sortie électrique différente si la situation se reproduit. Si les solutions ci-dessus ne corrigent pas la situation, veuillez contacter votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>
B. L'appareil fonctionne, le voyant d'alimentation est à "On" lorsque l'interrupteur est à "On." Le voyant rouge "Service Required" est allumé. Une alarme sonore peut sonner.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le filtre à air est bouché.</li> <li>2. L'échappement est bouché.</li> <li>3. La canule, le cathéter, le masque facial ou le tube d'oxygène est obstrué ou est défectueux.</li> <li>4. La bouteille de l'humidificateur est obstruée ou défectueuse.</li> <li>5. Le débitmètre est réglé a un trop niveau trop bas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez le filtre à air. Si le filtre est sale, lavez-le selon les instructions de nettoyage indiquées à la page 23.</li> <li>2. Vérifiez la zone d'échappement. Assurez-vous que rien ne bouché l'échappement de l'appareil.</li> <li>3. Détachez la canule, le cathéter ou le masque facial. Si le débit est adéquat ou est rétabli, nettoyez ou remplacez, au besoin. Débranchez le tube d'oxygène à la sortie d'oxygène. Si le débit adéquat est rétabli, vérifiez si le tube est tortillé ou s'il n'est pas obstrué. Remplacez le tube, si nécessaire.</li> <li>4. Détachez l'humidificateur de la sortie d'oxygène. Si vous obtenez un débit adéquat, nettoyez ou remplacez l'humidificateur.</li> <li>5. Réglez le débitmètre au débit prescrit par votre médecin. Si les solutions ci-dessus ne corrigent pas la situation, veuillez contacter votre fournisseur Sunrise Medical.</li> </ol>
C. L'appareil fonctionne, le voyant d'alimentation est à « on » lorsque l'interrupteur est à « on », un son basse-fréquence est détecté.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez votre appareil à "Off." Utilisez votre réserve d'oxygène et contactez immédiatement votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>
D. Si votre concentrateur d'oxygène présente d'autres difficultés.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez votre appareil à "Off." Utilisez votre réserve d'oxygène et contactez immédiatement votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>

#### TABLEAU DE DEPANNAGE MINEUR CONCENTRATEURS AVEC DE L'OSD - POUR LES CONCENTRATEURS AVEC OSD SEULEMENT

Voyants Indicateurs Visuels	Cause Possible	Solution
A. Les voyant vert (Niveau normal d'oxygène) et jaune (Bas niveau d'oxygène) sont soit à "On," soit à "Off."	1. Défectuosité de l'OSD.	1. Contactez votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.
B. Le voyant jaune (Bas niveau d'oxygène) est à "On" et le signal sonore intermittent est activé.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le débitmètre n'est pas bien réglé.</li> <li>2. Le filtre à air est obstrué.</li> <li>3. L'échappement est bouché.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le débitmètre est bien réglé au niveau prescrit.</li> <li>2. Vérifiez le filtre à air. Si le filtre est sale, lavez-le selon les instructions de nettoyage indiquées à la page 23.</li> <li>3. Vérifiez la zone d'échappement. Assurez-vous que rien n'obstrue l'échappement de l'appareil. Si les solutions ci-dessus ne corrigent pas la situation, veuillez contacter votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>
C. Le voyant "Service Required" est en position "On" et un signal sonore intermittent retentit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le débitmètre n'est pas bien réglé.</li> <li>2. Le filtre à air est obstrué.</li> <li>3. L'échappement est bouché.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le débitmètre est bien réglé au niveau prescrit.</li> <li>2. Vérifiez le filtre à air. Si le filtre est sale, lavez-le selon les instructions de nettoyage indiquées à la page 23.</li> <li>3. Vérifiez la zone d'échappement. Assurez-vous que rien n'obstrue l'échappement de l'appareil. Si les solutions ci-dessus ne corrigent pas la situation, veuillez contacter votre fournisseur Sunrise Medical/DeVilbiss.</li> </ol>

## CARACTÉRISTIQUES

	SÉRIE 5-LITRES DE DEVILBISS
<b>Numéro de Catalogue</b>	<b>515ADS, 515ADZ</b>
<b>Débit</b> (Faibles débits disponibles pour applications à faible débit)	1 to 5 LPM
<b>Débit maximal Recommandé</b>	5 LPM
<b>Pression de Sortie</b>	8.5 psig (58.6 kPa)
<b>Caractéristiques de Électrique</b>	115 V, 60 Hz, 4.1 Amp
<b>Plage de Tension de Service</b>	97-127 V~, 60 Hz
<b>Pourcentage d'Oxygène</b>	1-5 LPM=93%±3%
<b>Altitude d'Exploitation</b> (essai à 21°C seulement) 0-1500 M (0-4921 ft)	<i>Dans les limites de la plage de tension:</i> Pas de perte de performance
1500-3000 M (4921-9842 ft) 3000-4000 M (9842-13123 ft)	<i>Testé uniquement sous tension nominale:</i> En fonction de tests de produits comparables, aucune dégradation de la performance du produit n'est à prévoir. Pas recommandé/Pas testé
<b>Environnement d'Exploitation*</b> 10°C à 35°C, humidité comprise entre 30% et 75%	Pas de perte de performance dans les limites de la plage de tension de service (testé au niveau de la mer).
<b>Puissance Consommée</b>	385 Watts Average 515ADS uniquement -- 320 watts à 2,5 L/min et au-dessous
<b>Poids</b>	22.7 Kilograms (50 lbs.)
<b>Niveau de Bruit</b> (ISO 8359:1996 à partir de l'avant)	48.0 dbA moyenne globale**
<b>Dimensions</b>	27.75"H x 16"W x 14"D (70.5 x 40.6 x 35.6 cm)
<b>Soupage de Décharge</b>	40 psig±5psig (276 kPa±34.5 kPa)
<b>Système d'Exploitation</b>	Temporisé / Modulé en pression
<b>Pour les appareils équipés d'un dispositif d'oxygénation, l'indicateur visuel "Low Oxygen" (manque d'oxygène) se déclenchera aux concentrations suivantes:</b>	84%±2% (L'alarme sonore sera déclenchée à environ 75%. À moins de 60%, le voyant rouge "réparation nécessaire" s'allumera.)
<b>Conditions de Stockage</b>	-40°C à 70°C, humidité comprise entre 10% et 100%, inclure condensation
<b>Classe et Type d'Équipement</b>	<input type="checkbox"/> Equipement de classe II à isolation double <input checked="" type="checkbox"/> Partie appliquée de type B
<b>Organisme d'Approbation et Normes de Sécurité</b>	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90
<b>Respect EMC de:</b>	IEC 60601-1-2

\*Remarque: Les performances de l'OSD (dispositif d'alimentation en oxygène) entre 10 et 35° C, à 95 % de RH (humidité relative), dans la gamme de tensions sur le 515ADS, relevées à 670 m. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.







**Sunrise Medical**  
Respiratory Products Division  
100 DeVilbiss Drive  
Somerset, Pennsylvania 15501 USA  
814-443-4881

**Sunrise Medical Canada, Inc.**  
237 Romina Drive, Unit 3  
Concord, Ontario L4K 4V3  
CANADA  
905-660-2459

**Sunrise Medical Ltd.**  
Sunrise Business Park  
High Street  
Wollaston, West Midlands DY8 4PS  
ENGLAND  
44-138-444-6688


**Sunrise Medical Benelux**  
Pascalbaan 3  
Nieuwegein 3439 MP  
NETHERLANDS  
31-3060-82-100

**Sunrise Medical Pty. Limited**  
15 Carrington Road, Unit 7  
Castle Hill NSW 2154  
AUSTRALIA  
61-2-9899-3144

**Sunrise Medical**  
Division Respiratoire  
13 Rue de la Painguetterie  
37390 Chanceaux / Choisille  
FRANCE  
33-247-55-44-00

**Sunrise Medical**  
DeVilbiss Produkte  
Industriegebiet  
69254 Malsch/Heidelberg  
GERMANY  
49-7253-980-460

**Sunrise Medical**  
Rehabsenteret  
1450 Nesoddtangen  
NORWAY  
47-66-96-38-00



© 2005 Sunrise Medical Inc. 03.05  
A-515A Rev. A

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>